



### 滅菌 TYK 浅型シャーレ

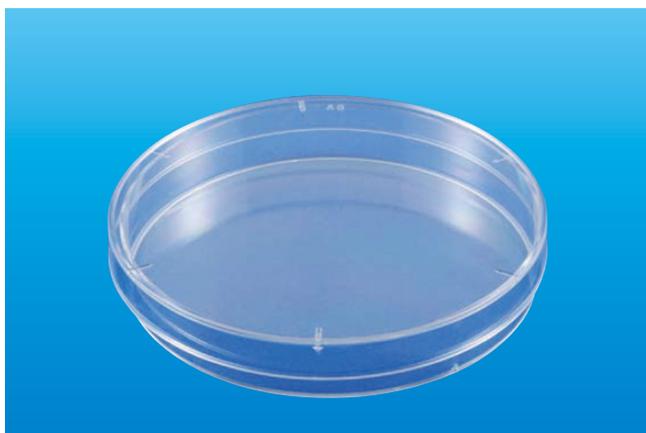


商品コード	サイズ	材質	包装形態	入数
21910	90φ×15mm	PS	10枚包装	500枚

### 滅菌 TYK 深型シャーレ

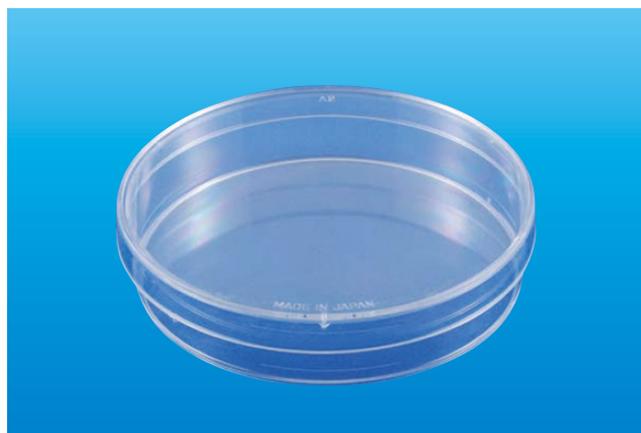

商品コード	サイズ	材質	包装形態	入数
21920	90φ×20mm	PS	10枚包装	500枚

### 滅菌 TYK オートシャーレ

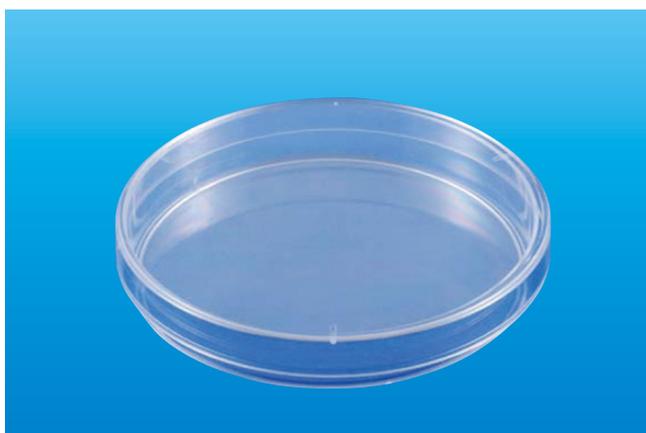

商品コード	サイズ	材質	包装形態	入数
21930	90φ×15mm	PS	20枚包装	500枚

### ■ 包装イメージ



東洋器材科学の滅菌製品は一袋ごとに製造年月日、使用期限の二つが印字されております。

これにより段ボールが処分されても、製造年月日、使用期限を包装から確認することができ、物品管理のお役に立てます。

## Q & A 7

special topics

## 医療機器ってどんなもの？

薬事法第2条では、『「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等（再生医療等製品を除く。）であって、政令で定めるものをいう。』と明確に定義されています。分かりやすく整理すると、

- ① ヒトか動物に用いられるものに限られ、
- ② 疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされている機械器具等、もしくは、
- ③ 身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等になります。

試験管

採尿セット

スポイト

容器・コップ

採便管

採水瓶

Swab・塗布用具

器具・その他